



El siguiente Boletín es elaborado con la información del segundo trimestre de 2025 con la finalidad de retroalimentar y fortalecer la seguridad de los medicamentos y dispositivos médicos.

FARMACOVIGILANCIA

Problemas relacionados con el uso de medicamentos PRUM: Es cualquier error que pueda causar daño al paciente y están relacionados con fallos en la prescripción, dispensación, almacenamiento, preparación, administración, educación, seguimiento y uso.

CONSEJO DE SEGURIDAD


CLARITOMICINA

Algunas de las reacciones adversas de la claritromicina son flebitis, dolor e inflamación en el sitio de la administración, dolor abdominal, náuseas, vómitos y diarrea.

Por este motivo se recuerda que la claritromicina polvo para reconstituir debe reconstituirse con 10 mL de agua estéril para inyección, realizando movimientos lentos para evitar la formación de espuma, la solución debe ser clara y sin partículas. Luego, se diluye en 250 mL de Dextrosa 5% o Cloruro de Sodio al 0,9% y se administra por infusión lenta en un tiempo de 60 minutos.


RAM

En la Gráfica 1. Se puede observar que la reacción adversa medicamentosa más común reportada durante el segundo trimestre de 2025

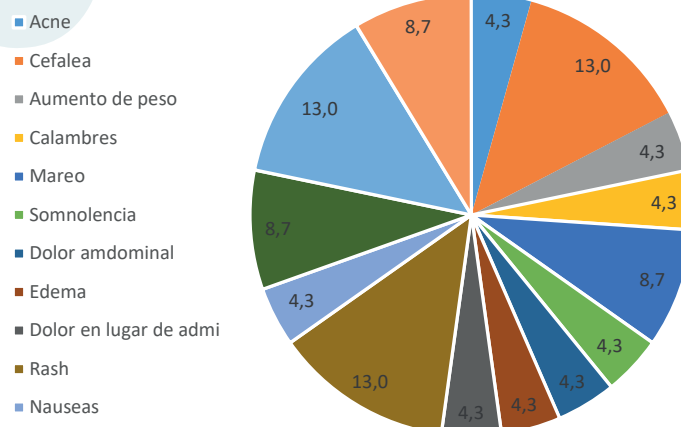

Gráfica 1. Reacciones Adversas Medicamentosas reportadas

En la Gráfica 2. Se puede observar los medicamentos reportados como causantes de Reacciones Adversas Medicamentosas, en los cuales los más comunes fueron

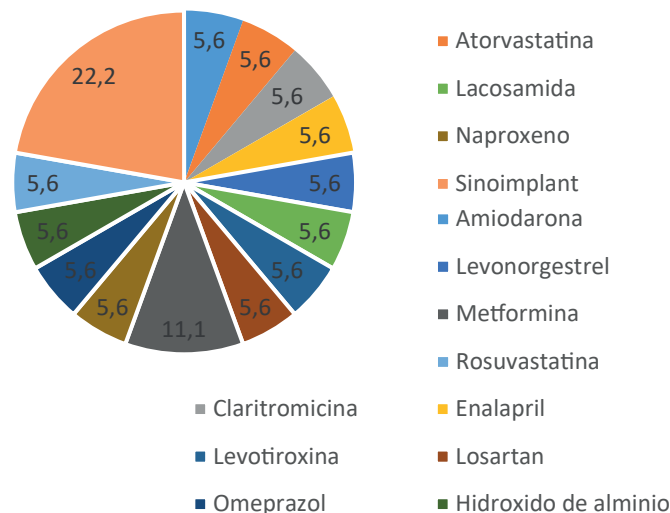



Grafica 2. Medicamentos reportados como causantes de Reacciones Adversas Medicamentosas

TECNOVIGILANCIA Y REACTIVOVIGILANCIA

CLASIFICACIÓN REACTIVOS DE DIAGNÓSTICO


Las clasificaciones de los reactivos de diagnóstico in vitro se basan en el riesgo sanitario que puede afectar al manipulador, se clasifican en:

Categoría III (alto riesgo)

Categoría II (mediano riesgo)

Categoría I (bajo riesgo)


En la Gráfica 3. Se evidencian los reportes realizados en los centros de salud por fallas de calidad durante el uso de los dispositivos médicos. Estos reportes sirven para gestionar con el fabricante y tener presente para futuras compras.



Grafica 3. Reportes de calidad en dispositivos médicos

En la Gráfica 4. Se observa que durante el II trimestre del 2025 no se identificó en página del Invima reporte de alertas sanitarias o informes de seguridad relacionadas con reactivos de diagnóstico o dispositivos médicos que manejan en los laboratorios clínicos de la empresa.


ALERTAS REACTIVOS DIAGNOSTICO INVITRO II SEMESTRE 2025



Grafica 4. Alertas Sanitarias o informes de seguridad

En la Gráfica 5. Durante el II trimestre del 2025 no se presentó ningún efecto indeseado con el uso de reactivos de diagnóstico in vitro en los laboratorios clínicos de la empresa.

EFFECTOS INDESEADOS REACTIVOS DIAGNOSTICO



Grafica 5. Efectos indeseados con el uso de reactivos de diagnóstico in vitro

RECONOCIMIENTOS

Agradecemos el compromiso de todos con la seguridad del paciente específicamente en el apoyo a los programa de farmacovigilancia y tecnovigilancia destacando el trabajo realizado por las siguientes 4 centros de salud quienes fueron los que más reportaron casos relacionados con medicamentos y dispositivos médicos durante el segundo trimestre de 2025.

Hospital Santa Mónica
CS San Vicente
CS Pandiaco
CS Primero de Mayo

Elaborado por:

Ing. Mario Naranjo
QF. Juliana Andrea Bolaños Ortiz
Dra. Laura Sandoval



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PASTO SALUD E.S.E